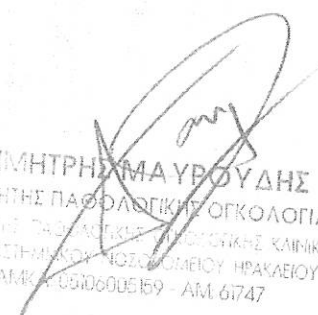
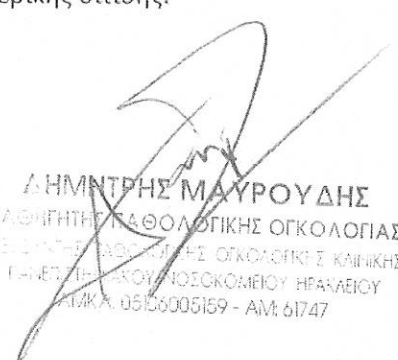


282119-282121 SCREW CAP ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ENFIT ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ D1 Συσκευή εντερικής σίτισης screwcap & spine, με ENFIT 3 way & ENFIT transition connector, συμβατή με ηλεκτρονική αντλία εντερικής σίτισης περισταλτικής κίνησης, η οποία να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με συσκευές μονού και διπλού ασκού, καθώς και με συσκευές τύπου screwcap, και διπλής συσκευής screwcap με ασκό νερού. Η αντλία επίσης να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με σωλήνα θέρμανσης διαλύματος. Η συσκευή screwcap & spine να είναι ENFIT και να διαθέτει διακόπτη ελέγχου ροής, ώστε να αποφεύγεται η ελεύθερη ροή των υγρών όταν το σετ δεν βρίσκεται συνδεδεμένο στην αντλία. Να διαθέτει σφικτήρα τύπου Robert, Leur lock και διακλάδωση δύο εισόδων (2way), για την ταυτόχρονη χορήγηση υγρών και φαρμάκων. Να αποτελείται από μη τοξικό PVC και από σωλήνα ιατρικής σιλικόνης μήκους 2m, DEHP-free. Να διατίθεται σε ατομική, αποστειρωμένη συσκευασία με συνόδευτική ετικέτα καταγραφής σημαντικών πληροφοριών, συσκευασμένη σε paper poly-bag. Ο ανάδοχος οφείλει να εξοπλίσει τον φορέα με αντίστοιχες αντλίες χορήγησης διαλυμάτων εντερικής σίτισης.


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΜΚΑ 0500005159 - ΑΜ 61747

387965 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ENFIT ΔΙΠΛΟΥ ΑΣΚΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ Α5 Συσκευή εντερικής σίτισης διπλού ασκού ENFIT 3 way & ENFIT transition connector, συμβατή με ηλεκτρονική αντλία εντερικής σίτισης περισταλτικής κίνησης, η οποία να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με συσκευές μονού και διπλού ασκού, καθώς και με συσκευές τύπου screwcap, και διπλής συσκευής screwcap με ασκό νερού. Η αντλία επίσης να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με σωλήνα θέρμανσης διαλύματος. Η συσκευή να αποτελείται από διαφανή ασκό σίτισης 1500ml & διαφανή ασκό νερού 1500ml, με καπάκια διακριτών χρωμάτων, μωβ και μπλε αντίστοιχα. Να διαθέτει διακόπτη ελέγχου ροής, ώστε να αποφεύγεται η ελεύθερη ροή των υγρών όταν το σετ δεν βρίσκεται συνδεδεμένο στην αντλία. Να διαθέτει σφικτήρα τύπου Robert, Leur lock και διακλάδωση δύο εισόδων (2way), για την ταυτόχρονη χορήγηση υγρών και φαρμάκων. Να αποτελείται από μη τοξικό PVC και από σωλήνα ιατρικής σιλικόνης μήκους 2m, DEHP-free. Να διατίθεται σε ατομική, αποστειρωμένη συσκευασία με συνοδευτική ετικέτα καταγραφής σημαντικών πληροφοριών, συσκευασμένη σε paper poly-bag. Ο ανάδοχος οφείλει να εξοπλίσει τον φορέα με αντίστοιχες αντλίες χορήγησης διαλυμάτων εντερικής σίτισης.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΝΟΚΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΤΜΚΑ 0510005159 - ΑΜ: 61747

Κωδ. : 27054

Προδιαγραφές για αυτοκόλλητο εξωτερικό καθετήρα σιλικόνης διαφόρων διαμετρημάτων.

Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας διαμετρημάτων 25 – 40 χιλ. από ελαστική σιλικόνη, διαφανής με ισορροπημένο κολλητικό. Η έξοδός του να έχει σχήμα σπирάλ ώστε να μπορεί να λυγίζει 90 μοίρες προς κάθε κατεύθυνση χωρίς να εμποδίζεται η ροή των ούρων. Με ειδικό δακτύλιο εφαρμογής και στις 2 πλευρές του εξωτερικού καθετήρα για ομοιόμορφη και καθαρή εφαρμογή. Με ενισχυμένο δακτύλιο σύνδεσης με ειδικές ραβδώσεις στο σωλήνα εξόδου για σύνδεση με ουροκαθετήρα.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΔΜΚΑ: 05106005159 - ΑΜ: 61747