

ΤΕΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ ΕΙΡ-2 ΕΡΒΕ GMBH
ΚΩΔ.252061**

Σετ σωληνώσεων μίας χρήσης, με συνδετικό Luer-Lock, και αιχμηρό άκρο για σύνδεση του με όλους τους τύπους ορού. Να διαθέτει μήκος εργασίας 2,5 μέτρα, και να είναι απολύτως συμβατός με τις αντλίες νερού τύπου ΕΙΡ2.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜ: 69541 - ΑΜΚΑ: 30075903010

ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 20Fr

ΚΩΔΙΚΟΣ: 282100

ΤΕΙ Υπογείου

Σετ ανταλλακτικού καθετήρα γαστροστομίας με ενσωματωμένο μπαλόνι, διαμέτρου 20fr, από ημιδιάφανη σιλικόνη υψηλής ποιότητας, για άμεση τοποθέτηση χωρίς τη χρήση ενδοσκοπίου. Ο σωλήνας σίτισης να έχει αποστρογγυλομένο εσωτερικό ακρό και να φέρει εξωτερική διαγράμμιση ανά 2cm για την εκτίμηση βάθους, ενσωματωμένη κεφαλή σίτισης 2 δρόμων για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων, Ομόκεντρο μπαλόνι σταθεροποίησης των 20ml ανθεκτικό στο pH του στομάχου και ανατομικά πέλματα σιλικόνης για την καθήλωση του στο δέρμα. Το σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ασφαλή στερέωσή του στο τοίχωμα του στομάχου (χωρίς ραφές στο δέρμα). Να συμπεριλαμβάνεται καθώς και υδατοδιαλυτού λιπαντικού gel.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜ: 69641 - ΑΜΚΑ: 30075903010

**ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΣΕΤ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ PULL. 20Fr**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 281353

ΤΕΙ Υπογείου

Σετ γαστροστομίας ενδοσκοπικά τοποθετούμενες δια μέσου οδηγού σύρματος (Pull Type) 20 FR το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει: Γαστροστομία με θόλο (Dome), από μαλακή, ακτινοσκοιερή σιλικόνη που να παρέχει την δυνατότητα αφαίρεσης της συσκευής απευθείας χωρίς να είναι απαραίτητη η διαδικασία ενδοσκοπικής αφαίρεσης. Καθετήρας Γαστροστομίας αντικατάστασης από μαλακή σιλικόνη, με διαβαθμίσεις, με άκρο από ομόκεντρο μπαλόνι και με στρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο. Σε μέγεθος 20Fr. Ευθύς εξωτερικός δίσκος/ενίσχυση που επιτρέπει την καθήλωση στο δέρμα χωρίς ράμμα. Χειρουργικό πεδίο με θυρίδα (περίπου 61cmx91cm), Χειρουργικό νυστέρι (λεπίδα νο11), αναλώσιμη σύριγγα 5ml, αποστειρωμένες γάζες (10cm x 10cm), Βελόνα 21Gx38.1mm και βελόνα 25Gx25.4mm, Αναλώσιμη μεταλλική αιμοστατική λαβίδα, Αντάπτορα σίτισης διπλής εξόδου, 14G βελόνα/ κάνουλα. Θηλιά εισαγωγής. Αναλώσιμο βρόγχο σύλληψης. Αναλώσιμο μεταλλικό ψαλίδι.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜ: 69541 - ΑΜΚΑ: 30675903010

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ 247678

Σετ νηστιδοστομίας για τοποθέτηση με τεχνική Pull 9-12F που να περιλαμβάνει καθετήρας για τη νήσιδα, με επικάλυψη ολισθηρού υλικού όπως πουουρεθάνη για εύκολη εισαγωγή, αντάπτορα διπλής εξόδου, που επιτρέπει την ταυτόχρονη σίτιση και αποσυμπίεση του καθετήρα και στυλεό.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜ: 69541 - ΑΜΚΑ: 30075903010

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΥΔΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 330753

Πλαστικές φιάλες ύδατος για την φωτεινή πηγή πολλαπλών χρήσεων διαφόρων τύπων για τις πηγές του νοσοκομείου-fujifilm με χρήση διοξειδίου CO₂.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜ: 69541 - ΑΜΚΑ: 30075903010

Τ.Ε.Ι. ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ 66229

ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΡΜΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ. Χ.

ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΡΜΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ



ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜ: 69541 - ΑΜΚΑ: 30075903010

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Μ.Χ.
ΚΩΔ.284318


Λαβίδες βιοψίας γαστροσκοπίου μιας χρήσεως. Να διαθέτουν σιαγώνες μήκους 3mm έως 6mm, για τη λήψη μεγάλου ιστοτεμαχιδίου. Να έχει επικαλυμμένο θηκάρι για μείωση τριβών με ακίδα ή χωρίς και διπλό παράθυρο για λήψη μεγάλου ιστοτεμαχιδίου. Να διατίθεται σε μήκος απο 160cm έως 190cm και διαμέτρο σιαγόνας 1,8mm η μεγαλύτερο. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜ: 69541 - ΑΜΚΑ: 30075903010

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ Μ.Χ.(ΚΩΔ324032)

Λαβίδες βιοψίας κολονοσκοπίου μιας χρήσεως με σύστημα σύρματος μονής έλξης (mono pull wire) που εξασφαλίζει την σταθερότητα των σιαγόνων για την προστασία του καναλιού εργασίας των ενδοσκοπίων. Να διαθέτουν σιαγώνες μήκους 3mm και βάθους μεγαλύτερου από 0,95mm, για τη λήψη μεγάλου ιστοτεμαχιδίου διαστάσεων τουλάχιστον 7,5 κυβικών χιλιοστών. Να έχει επικαλυμμένο θηκάρι για μείωση τριβών με ακίδα ή χωρίς και διπλό παράθυρο για λήψη μεγάλου ιστοτεμαχιδίου. Να διαθέτουν προειδοποιητικούς δείκτες θέσης και χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση και επιλογή κατά την διάρκεια της ενδοσκόπησης. Να διατίθεται σε μήκος 230cm και διάμετρο σιαγόνων 2,3mm με ειδικό δειγματολήπτη ιστού. Να μην περιέχουν latex και PVC για την πρόληψη αλλεργιών. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜ: 69541 - ΑΜΚΑ: 3007590010

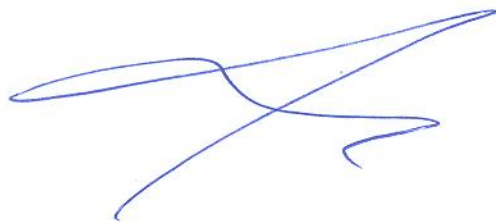

ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 181846

ΤΕΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Σετ ενδοσκοπικής περίδεσης κισών οισοφάγου μονού ράμματος, πολλαπλών δακτυλίων (7) από υποαλλεργικό υλικό πολυισοπρενίου, με ειδικό τετράγωνο σχεδιασμό για απόλυτη εφαρμογή στον κισό μετά την απελευθέρωσή του. Το σύστημα των δακτυλίων να διαθέτει άκρο σιλικόνης για την προστασία του ενδοσκοπίου και προειδοποιητικό προτελευταίο δακτύλιο γκρι χρώματος. Να διαθέτει λαβή με χαρακτηριστικό ήχο κατά την απελευθέρωση του εκάστοτε δακτυλίου, καθώς και υποδοχή καθετήρα πλύσης. Να είναι συμβατό με ενδοσκόπια διαμέτρου 8,5-11,5mm. Να μην περιέχει latex.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜ: 69541 - ΑΜΚΑ: 30075903010

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΩΡΤΟΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ κωδικός 291544

Προφορτωμένα περιστρεφόμενα αιμοστατικά κλιπ μιας χρήσεως διαμετρου 2.6mm για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε πλήρως επικαλυμένο καθετήρα μήκους 230cm συμβατά με κανάλι εργασίας 2.8mm και 3.2mm. Να διαθέτουν άνοιγμα σιαγώνων 16mm με γωνία 90 και 135 μοιρών. Να έχουν δυνατότητα περιστροφής, καθώς και δυνατότητα πολλαπλών ανοιγμάτων πριν από την τελική απελευθέρωση τους. Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο. Να έχουν ειδικό σύστημα για την αφαίρεσή τους με ασφάλεια μετά την τελική απελευθέρωσή τους στον βλεννογόνο. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.


ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜ: 69541 - ΑΜΚΑ: 30075903010

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΩΡΤΟΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS κωδικός 287057

Προφορτωμένα περιστρεφόμενα αιμοστατικά κλιπ μιας χρήσεως διαμετρου 2.6mm για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε πλήρως επικαλυμένο καθετήρα μήκους 230cm συμβατά με κανάλι εργασίας 2.8mm και 3.2mm. Να διαθέτουν άνοιγμα σιαγώνων 11mm με γωνία 90 και 135 μοιρών. Να έχουν δυνατότητα περιστροφής, καθώς και δυνατότητα πολλαπλών ανοιγμάτων πριν από την τελική απελευθέρωση τους. Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο. Να έχουν ειδικό σύστημα για την αφαίρεσή τους με ασφάλεια μετά την τελική απελευθέρωσή τους στον βλεννογόνο. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜ: 69541 - ΑΜΚΑ: 30075903010