

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ:

332800 (1)

Υβριδικός Καθετήρας Νευροακτινολογίας μεγάλου αυλού συμβατός με αντλία. Υβριδικός καθετήρας νευροακτινολογίας και θηκάρι μεγάλου αυλού με εσωτερική διάμετρο 0.088" κατασκευασμένο από ενισχυμένο πολυμερές με σκελετό από stainless steel. Το εγγύς άκρο να είναι πιο εύκαμπτο, επιτρέποντας την τοποθέτησή του σε υψηλότερο ανατομικά σημείο εν συγκρίσει με τα συμβατικά μακριά θηκάρια. Το άκρο να διατίθεται σε ευθύ και multi-purpose. Να είναι συμβατός με σύρμα 0.035" και 0.038". Να προσφέρεται μαζί με περιστρεφόμενη αιμοστατική βαλβίδα, crosscut βαλβίδα και dilator. Το άπω (distal) άκρο να έχει εύκαμπτη ζώνη 4εκ. και υδρόφιλη επικάλυψη 7εκ.

332822 (1)

Ειδικός υβριδικός καθετήρας αναρρόφησης, μεγάλου εσωτερικού αυλού, με ειδικό πλέγμα στο κυρίως σώμα και σπείραμα 17 & 19cm στο άπω τμήμα του και υδρόφιλη επικάλυψη, με δυνατότητα διαμόρφωσης του τελικού άκρου σε διάφορα σχήματα. Να έχει διαβαθμισμένη σκληρότητα για ομαλή παράκαμψη της οφθαλμικής αρτηρίας. Διατίθεται σε μήκη καθετήρα 125 - 131cm και σε διαμέτρους 5 - 6F.

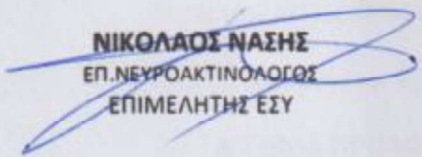
391391 (2)

Ενδοανευρυσματική συσκευή εμβολισμού, κατάλληλη για εμβολισμό ενδοκράνιων ανευρυσμάτων. Να διαθέτει σχήμα μεταξύ σφαίρας και κυλίνδρου για βέλτιστη προσαρμογή στο σάκο του ανευρύσματος. Να διαθέτει διπλό πλέγμα από 144 σύρματα nitinol τεχνολογίας DFT για βέλτιστη ακτινοσκιερότητα. Να είναι πλήρως ατραυματική, χωρίς κάποιο marker στην εξωτερική πλευρά της συσκευής που βρίσκεται εσωτερικά στο ανεύρυσμα. Να διαθέτει pusher από nitinol μήκους 183cm με Fluro safe marker. Να διατίθεται σε διαμέτρους συσκευής 4.5mm έως 8mm και σε ύψη 3.0mm έως 5mm. Όλες οι διαστάσεις της συσκευής εμβολισμού να είναι συμβατές με μικροκαθετήρα .021".

391392 (1)

Συσκευή αποκόλλησης συμβατή με ενδοανευρυσματική συσκευή
εμβολισμού ARTISSE

01.10.2025


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΣΗΣ
ΕΠ. ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΣΥ