

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΧΜΘ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ε.ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΤΗΛ.2318

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

8/7/2026

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

- 1)Η συσκευή να είναι απαλλαγμένη από φθαλικά και latex και να διαθέτει ενσωματωμένο μη αποσπώμενο κλιπ προστασίας από την ελεύθερη ροή.
- 2)Να φέρει ρύγχος διάτρησης με προστατευτικό κάλυμμα, χωρίς αεραγωγό για ασκούς αίματος σύμφωνα με ISO 1133/4 ,διαφανή σταγονοθάλαμο με φίλτρο αίματος 200μ(επιφάνειας >10cm²)
- 3)Να καταλήγει σε σύνδεσμο σύνδεσμο Luer lock περιστρεφόμενο.
- 4)Η συσκευή στο άκρο της να φέρει υδρόφοβο πώμα για προστασία από μολύνσεις.
- 5)Να έχει συνολικά μήκος συσκευής περίπου 285cm όγκο πλήρωσης περίπου 25ml,να είναι πλήρως αποστειρωμένη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

- .Να έχει Ελληνικό μενού
- .Να είναι Class II για προστασία από ηλεκτροπληξία
- .Να είναι Class IIb σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί 1/Π (CE)
- .Να έχει πιστοποίηση τουλάχιστον IP22 για ολόκληρο το μηχάνημα
- .Να λειτουργεί χωρίς την χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή και να έχει δυνατότητα ροής έως 1.500ml/h.
- .Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία που να εξασφαλίζει λειτουργία της αντλίας για τουλάχιστον 8 ώρες σε ροή 25ml/h και να φορτίζει ανεξαρτήτως ροής λειτουργίας.
- .Να διαθέτει ειδοποίηση για πτώση πίεσης στην γραμμή έγχυσης (αποσύνδεση ασθενή)και δυνατότητα απενεργοποίησης του KVO.
- .Το βάρος της να είναι μικρότερο των 2kg και να διαθέτει φυσικά πλήκτρα ρύθμισης ροής για ευχρηστία.

Ο Διευθυντής του τμήματος


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η Προϊσταμένη του τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΧΜΘ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ε.ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΤΗΛ.2310

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

8/7/2006

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Προδιαγραφές σετ χορήγησης φωτοευαίσθητων διαλυμάτων μέσω ηλεκτρονικής αντλίας που να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- .Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα.
- .Διαφανής εύκαμπτος σταγονοθάλαμος με φίλτρο κατακράτηση αέρα και δυσδιάλυτων ουσιών 4μm στο κάτω μέρος του σταγονομετρικού θαλάμου (από υλικό που αποτρέπει την εισροή αέρα στο σετ, μετά το τέλος του υγρού).
- .Η συσκευή έγχυσης να είναι ακτινοσκιερή καθόλο το μήκος της συμπεριλαμβανομένου του σταγονοθάλαμου.
- .Ολισθαίνων κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή ροής.
- .Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή.
- .Αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα για προστασία από μολύνσεις.
- .Συνολικό μήκος συσκευής 250cm και όγκος πλήρωσης 26ml.
- .Σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένη με αιθυλονοξείδιο DEHP_free, Latex_free, PVC_free.

- .Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες.
- .Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.

Η ηλεκτρονική αντλία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

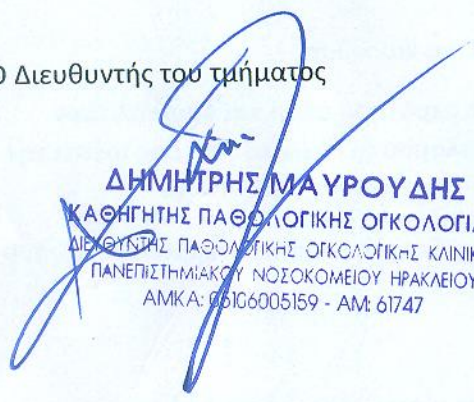
- .Να έχει Ελληνικό μενού
- .Να είναι Class II για προστασία από ηλεκτροπληξία
- .Να έχει πιστοποίηση τουλάχιστον IP22 για ολόκληρο το μηχάνημα
- .Να λειτουργεί χωρίς τη χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή
- .Να έχει την δυνατότητα ροής έως 1.500ml/h.
- .Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία που να εξασφαλίζει λειτουργία της αντλίας για τουλάχιστον 8 ώρες σε ροή 25ml/h και να φορτίζει ανεξαρτήτως ροής λειτουργίας.

.Να διαθέτει ειδοποίηση για πτώση πίεσης στη γραμμή έγχυσης (αποσύνδεση ασθενή) και δυνατότητα απενεργοποίησης του KVO.

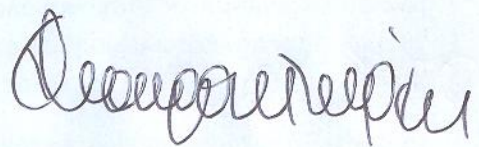
.Το βάρος της να είναι έως 2kg και να διαθέτει φυσικά πλήκτρα ρύθμισης ροής για ευχρηστία.

.Να διαθέτει ρύθμιση του ορίου συναγερμού φραγής σε βήματα των 50mm Hg στο εύρος από 50-750 mm Hg.

Ο Διευθυντής του τμήματος


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΜΚΑ: 06106005159 - ΑΜ: 61747

Η Προϊσταμένη του τμήματος



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΧΜΘ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ε.ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΤΗΛ.2310

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

8/7/2026

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ

Προδιαγραφές σετ χορήγησης φαρμάκων και υγρών, μέσω ηλεκτρονικής αντλίας που να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό με αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα.
2. Διαφανής εύκαμπτος με φίλτρο κατακράτησης αέρα και δυσδιάλυτων ουσιών 4μm στο κάτω μέρος του σταγονομετρικού θαλάμου (από υλικό που αποτρέπει την εισροή αέρα στο σετ, μετά το τέλος του υγρού.)
3. Ολισθαίνων κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής.
4. Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή.
5. Πλάγια διακλάδωση τύπου <<Y>> χωρίς τη χρήση βελόνης για αντιμικροβιακή προστασία.
6. Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα για προστασία από μολύνσεις.
7. Συνολικό μήκος συσκευής 265cm και όγκο πλήρωσης 27ml.
8. Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο, DEHP_free, Latex_free
9. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες.
9. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.

Η Ηλεκτρονική αντλία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά

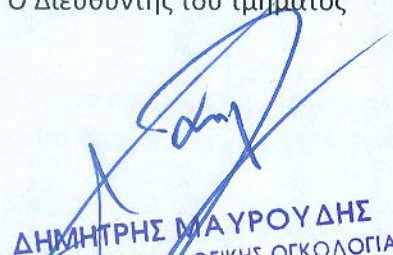
- .Να έχει Ελληνικό μενού
- .Να είναι Class II για προστασία από ηλεκτροπληξία.
- .Να έχει πιστοποίηση τουλάχιστον IP22 για ολόκληρο το μηχάνημα.
- .Να λειτουργεί χωρίς τη χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή και να έχει δυνατότητα ροής έως 1500ml/h.
- .Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία που να εξασφαλίζει λειτουργία της αντλίας για τουλάχιστον 8 ώρες σε ροή 25 ml/h και να φορτίζει ανεξαρτήτως ροής λειτουργίας.

.Να διαθέτει ειδοποίηση για πτώση πίεσης στη γραμμή έγχυσης (αποσύνδεση ασθενή) και δυνατότητα απενεργοποίησης του KVO.

.Το βάρος της να είναι μικρότερο των 2kg και να διαθέτει φυσικά πλήκτρα ρύθμισης ροής για ευχρηστία.

.Να διαθέτει ρύθμιση του ορίου συναγερμού φραγής σε βήματα των 50 mm Hg στο εύρος από 50-750 mmHg.

Ο Διευθυντής του τμήματος


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΜΚΑ: 05106005159 - ΑΜ: 61747

Η Προϊσταμένη

