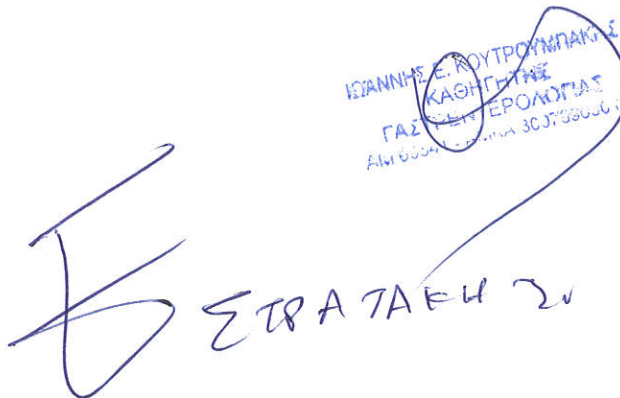


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ **ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**

1. Να προσφερθεί αναρρόφηση τροχήλατη, κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση, αναρροφητικής ικανότητας μέχρι περίπου 40 lit/min.
2. Να διαθέτει διακόπτη ON-OFF με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας καθώς και περιστρεφόμενο κομβίο για την ρύθμιση της ισχύος καθώς και όργανο (μανόμετρο) για την ένδειξη του κενού.
3. Να διαθέτει μία ή δύο φιάλες άθραυστες των 2lit η κάθε μία, αποστειρούμενες και εξάρτημα ή θέση συγκράτησης των φιαλών.
4. Να διαθέτει τριπλό σύστημα προστασίας κατά της υπερχειλίσης.
5. Το περίβλημα της αναρρόφησης να είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ειδικό αντιστατικό και άθραυστο πλαστικό υλικό.
6. Να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς.
7. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και διαθέτει σύστημα λειτουργίας που δεν απαιτεί συντήρηση.
8. Να διαθέτει αντιμικροβιακό φίλτρο.
9. Να μπορεί να λειτουργήσει και με σακούλες μιας χρήσης των 2 λίτρων χωρίς καμία απολύτως μετατροπή.
10. Να διαθέτει 4 τέσσερις αντιστατικές ρόδες με δυνατότητα πέδησης.
11. Να διαθέτει ποδοδιακόπτη λειτουργίας.
12. Να είναι αθόρυβη (επίπεδο θορύβου έως 40 db).
13. Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220V.
14. Να είναι αντιακρηκτικού τύπου.
15. Η συσκευή να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και λοιπά εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων.
16. Κατά την παράδοση, να δοθούν τα Εγχειρίδια Χρήσεως (Operation Manual) της συσκευής στα Ελληνικά .
17. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού θα πρέπει να

διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).

19. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 13485 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.
20. Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.
21. Να καλύπτεται με εγγύηση (2) δύο ετών τουλάχιστον.
22. Να καλύπτεται από ανταλλακτικά και service για (10) δέκα έτη τουλάχιστον.
23. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης να είναι εντός (60) εξήντα ημερών από την παραγγελία.
24. Να δοθεί κατάλογος με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς και τιμοκατάλογος των πιθανών αναλώσιμων ανταλλακτικών που απαιτούνται για την χρονική περίοδο μετά την λήξη της εγγύησης του μηχανήματος.
25. Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης στις τεχνικές προδιαγραφές, με σχετικές παραπομπές στα εγχειρίδια του μηχανήματος.


ΕΣΤΕΧ