

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**  
**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**  
**ΠΑΓΝΗ**

**1. Αντικείμενο του έργου.**

Αντικείμενο του έργου είναι η από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους ενέργειας, επέμβαση και φροντίδα για την άψογη λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και όλους τους κανόνες της επιστήμης και τις τεχνικές, τις λειτουργικές προδιαγραφές του εξοπλισμού αυτού και τις κατασκευαστικές οδηγίες, τις οποίες όπως δηλώνει ρητώς ο εκπρόσωπος της, γνωρίζει η ίδια και το προσωπικό της αυτό.

Συγκεκριμένα τα μηχανήματα του τμήματος κεντρικής αποστείρωσης που αποτελούν αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι :

1. τρεις (3) κλίβανοι COLUSSI - U63PV του οίκου ICOS/ITALIA
2. πέντε(5) πλυντήρια εργαλείων LANCER – HOSPITALIA / ΓΑΛΛΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για Δεκαοχτώ μήνες είναι:

A/A	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜ	ΠΟΣΟ
1	Κλίβανοι	3	13500	40500
2	Πλυντήρια	5	5400	27000
		<b>Σύνολο</b>		<b>67500</b>

**2. Ορισμοί**

Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί, με τις αντίστοιχες έννοιες:

- 2.1. «Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος, καθαρισμός, ρύθμιση, και προγραμματισμός του εξοπλισμού όπου απαιτείται, καθώς και η δοκιμή αυτού υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
- 2.2. «Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» για την επιδιόρθωση βλαβών, με η χωρις την ανάγκη αντικατάστασης ανταλλακτικών, των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιούμενων προς την «ΑΝΑΔΟΧΟ» είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.

2.3. «Αναλόσιμα & ανταλλακτικά» θεωρούνται τα πάσης φύσεως, εξαρτήματα, εξοπλισμός η άλλου είδους υλικά που απαιτούνται να τοποθετηθούν η να χρησιμοποιηθούν επί των μηχανημάτων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσης σύμβασης έτσι ώστε τα μηχανήματα αυτά να λειτουργούν χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα

2.4. «Ανωτέρα βία» σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του.

Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται σε: θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και (ή) εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

### **3. Υποχρεώσεις συντηρήσιας εταιρείας:**

Η Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις (προληπτική συντήρηση, επανορθωτική συντήρηση, κλπ) επί του εξοπλισμού που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης της παρούσης σύμβασης έτσι ώστε ο εξοπλισμός αυτός να λειτουργεί αδιάλειπτα, και απρόσκοπτα καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Όλα τα αναλόσιμα και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την επανορθωτική και προληπτική συντήρηση του αντικειμένου στης παρούσης σύμβασης είναι υποχρέωση της ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Ως αναλόσιμο υλικό θεωρούνται και τα παρακάτω ανταλλακτικά-υλικά:

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ(ΛΑΣΤΙΧΟ) ΘΥΡΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ	-
2	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ	-
3	ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ	-
4	ΓΡΑΦΙΔΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ	ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί προληπτικές συντηρήσεις τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.

Οι διάφορες εργασίες συντήρησης – επισκευής του εξοπλισμού θα πραγματοποιούνται παρουσία τεχνικών του νοσοκομείου και υποχρεούνται να

παρέχει οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες της ζητηθούν κατά την διάρκειά της.

Σε περίπτωση βλάβης η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» είτε με την λήψη έγγραφης ή τηλεφωνικής ειδοποίησης, υποχρεούται εντός 12 ωρών να παρευρίσκεται επί τόπου στο Νοσοκομείο για την αποκατάσταση της βλάβης.

Θα πρέπει Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ να παρέχει την δυνατότητα να ενημερώνεται από το προσωπικό του Νοσοκομείου για τις βλάβες καθ' όλο το 24ωρο. Η ολοκλήρωση της επισκευής να πραγματοποιείται εντός 10ώρου από την έναρξη της επισκευής.

Για τον σκοπό αυτό η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα γνωρίσει με την έναρξη της ισχύος της σύμβασης αριθμό τηλεφώνου, κινητού, fax μέσω των οποίων το «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» θα μπορεί να έλθει σε επικοινωνία με την «ΑΝΑΔΟΧΟ» καθ' όλο το 24ωρο.

Σε περίπτωση βλαβών που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε διακοπή σημαντικής λειτουργίας του εξοπλισμού η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται όπως αμελλητί προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την «άμεση» αποκατάσταση της βλάβης.

Όλα τα έξοδα μετακίνησης(εισιτήρια), διατροφής, διαμονής και συναφή έξοδα, θα βαρύνουν αποκλειστικά την «ΑΝΑΔΟΧΟ».

Όλα τα γενικά έξοδα της συντήρησης (εισιτήρια, μεταφορικά, διαμονή) θα βαρύνουν αποκλειστικά την «ΑΝΑΔΟΧΟ».

Η εταιρεία συντήρησης υποχρεούται να διατηρεί στον χώρο εγκατάστασης βιβλίο αναγραφής λειτουργίας βλαβών και συντήρησης του εξοπλισμού του Τμήματος καθώς επίσης και μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, με περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, καθώς και των ανταλλακτικών που έχουν αντικαταστεί και αυτών που χρήζουν αντικαταστάσεως.

Λόγο παλαιότητας του προς συντήρηση εξοπλισμού σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν δύναται να τον επισκευάσει λόγο έλλειψης ανταλλακτικών τότε διακόπτεται η σύμβαση στο μέρος του εξοπλισμού που τίθεται εκτός λειτουργίας και η σύμβαση συνεχίζεται κανονικά με το ανάλογο τίμημα.

#### **4. Υπογρεώσεις του νοσοκομείου**

Το νοσοκομείο υποχρεούται να διαθέτει στον τεχνικό της εταιρείας συντήρησης κατά το διάστημα της επίσκεψης του στο νοσοκομείο, κατάλληλους χώρους για να εργαστεί και να ελέγχει τον εξοπλισμό.

Τυχόν βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (φωτιά, πλημμύρα κλπ.) ή τρίτους προς το σύστημα ή σε κακό χειρισμό των χρηστών επιβαρύνουν το νοσοκομείο.

Το νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει την εταιρεία συντήρησης για κάθε είδους επέμβαση στα μηχανήματα.

### **5. Διάρκεια σύμβασης**


Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα **Δύο (2) μηνών,** και **προυπολογισμός 7.500 ευρώ με Φ.Π.Α.**

ΓΙΑ ΤΟ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ



ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

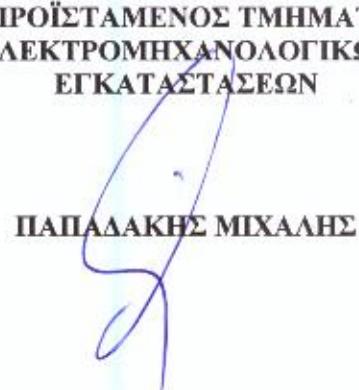

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ