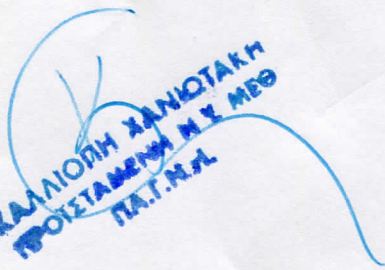


**Τεχνικές Προδιαγραφές Ρινογαστρικού Καθετήρα για την
μέτρηση Οισοφαγείου και Γαστρικής πίεσης
ΚΩΔ. 217112**

1. Να είναι ρινογαστρικός καθετήρας τριπλής λειτουργίας:
 - Μέτρησης της οισοφαγικής πίεσης
 - Μέτρησης της γαστρικής πίεσης (κοιλιακής πίεσης)
 - Σίτισης/παροχέτευσης του ασθενούς
2. Το υλικό κατασκευής να είναι από πολυουρεθάνη και η βιοσυμβατότητα των υλικών να επιτρέπει την παρατεταμένη χρήση του καθετήρα.
3. Να διαθέτει ακτινοσκοπική λωρίδα κατά μήκος ολόκληρου του μήκους του καθετήρα, με δείκτες στα σημεία που βρίσκονται το γαστρικό και το οισοφάγειο μπαλόνι, για να διασφαλιστεί η ορθή τοποθέτησή του.
4. Να διαθέτει δύο μπαλόνια για τη μέτρηση της οισοφαγικής και της γαστρικής πίεσης.
5. Συνδετικό τύπου Y για χορήγηση υγρών.
6. Να παραδίδεται πλήρης έτοιμος προς χρήση με:
 - Ρινογαστρικό καθετήρα (σύμφωνα με τα παραπάνω)
 - Συρμάτινο οδηγό
 - Σύριγγα 10ml
 - Λιπαντική γέλη (για καθετήρα και οδηγό)


ΚΑΛΙΟΠΗ ΧΑΛΙΩΤΑΚΗ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Μ.Υ. ΜΕΘ
ΠΑ.Γ.Ν.Α.